Liste des outils à disposition

- Manuel d'utilisation
- Guide rapide d'utilisation
- Guide de récupération de données

Références accessoires/consommables

		Hôpital		Domicile	
		Fisher&Paykel HEALTHCARE	WILAmed	Fisher&Paykel HEALTHCARE	WILAmed
Adulte	Modèle d'humidificateur	MR850	AIRcon	HC550	AIRcon
	Circuit	RT202	271.125	RT102	271.125
	Chambre d'humidification			HC325	C100M
	Canules nasales	F&P	WILAMED	F&P	WILAMED
Pédiatrique	Humidificateur	MR850		HC550	
	Circuit	RT330		RT330	
	Chambre d'humidification			HC325	
	Canules nasales	F&P		F&P	

ATTENTION :
le tuyau diamètre 22 mm (entre le respirateur et l'humidificateur) n'est pas inclus dans le kit pédiatrique.

Contact
Air Liquide Healthcare
6990 Creditview Road, Unit 6
Mississauga, Ontario L5N 8R9
www.airliquidehealthcare.ca

0 820 146 359

CE

Air Liquide HEALTHCARE

Air Liquide Healthcare est un leader mondial des gaz médicaux, de la santé à domicile, des produits d'hygiène et des ingrédients de spécialité santé. Il a pour mission de fournir à ses clients, tout au long du parcours de soins de l'hôpital au domicile, des produits médicaux, des ingrédients de spécialité et des services qui contribuent à protéger les vies vulnérables.

02/2019 - Crédits photos : © Air Liquide - Création et illustrations CHANH THI

Air Liquide HEALTHCARE | EO-150

EO-150 by EOVE

Guide d'utilisation C-FLOW

Ce guide ne remplace pas le manuel utilisateur

Destiné à toute personne habilitée aux réglages

Guide d'utilisation C-FLOW

C-FLOW fonctionnement

PRINCIPE :
un débit d'air continu est délivré par l'intermédiaire d'un humidificateur chauffant et d'une canule nasale (oxygénation si ajout d'O_2).
En cas d'atteinte de la Pmax, la pression délivrée ne dépassera pas cette valeur.

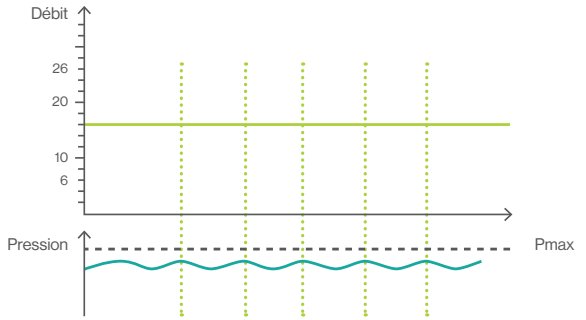

ATTENTION :
utilisation impérative d'un humidificateur chauffant

Concentration du mélange gazeux
(en % d'O_2)

	Débit réglé (L/min)					
	15	20	30	40	50	60
Débit O_2 (L/min) 4	42	37	32	29	27	26
8	63	53	42	37	34	32
12	84	68	53	45	40	37
16	—	84	63	53	46	42
20	—	—	74	61	53	47
25	—	—	88	63	55	54
30	—	—	97	65	59	57

ATTENTION :
À faible débit de consigne, la FiO_2 peut être légèrement diluée par l'air inhalé.

Réglage du mode C-FLOW

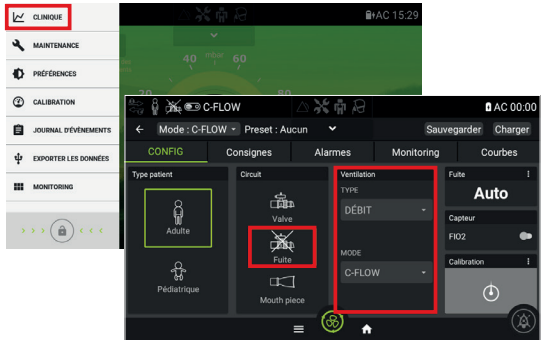

Sélectionner **"Clinique"**, puis depuis l'onglet **"CONFIG"** choisir le **mode à fuites ,** un type de ventilation en **Débit** et le mode **C-Flow**.

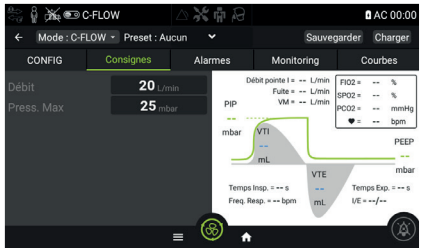

Régler les paramètres depuis l'onglet **"Consignes"**:

Réglages	Adulte	Pédiatrique
Débit	10 - 60 L/min	2 - 25 L/min
Défaut	20 L/min	20 L/min
P. Max	7 - 50 mbar	7 - 50 mbar
Défaut	25 mbar	15 mbar

Configuration du circuit
(simple branche uniquement)

Branchements : depuis l'humidificateur

- Raccorder le circuit patient
- Brancher la double sonde de température et l'adaptateur électrique du circuit chauffé
- Mettre en place la canule nasale
- Obturer les connectiques expiratoires avec le *capuchon* (KC072247)
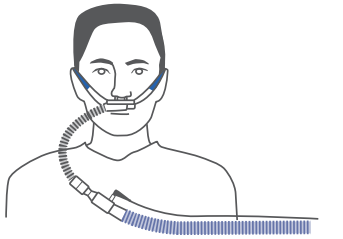
Sélectionner **"mode invasif"** ou **"Free"** sur l'humidificateur (suivant les modèles)